Unknown 45

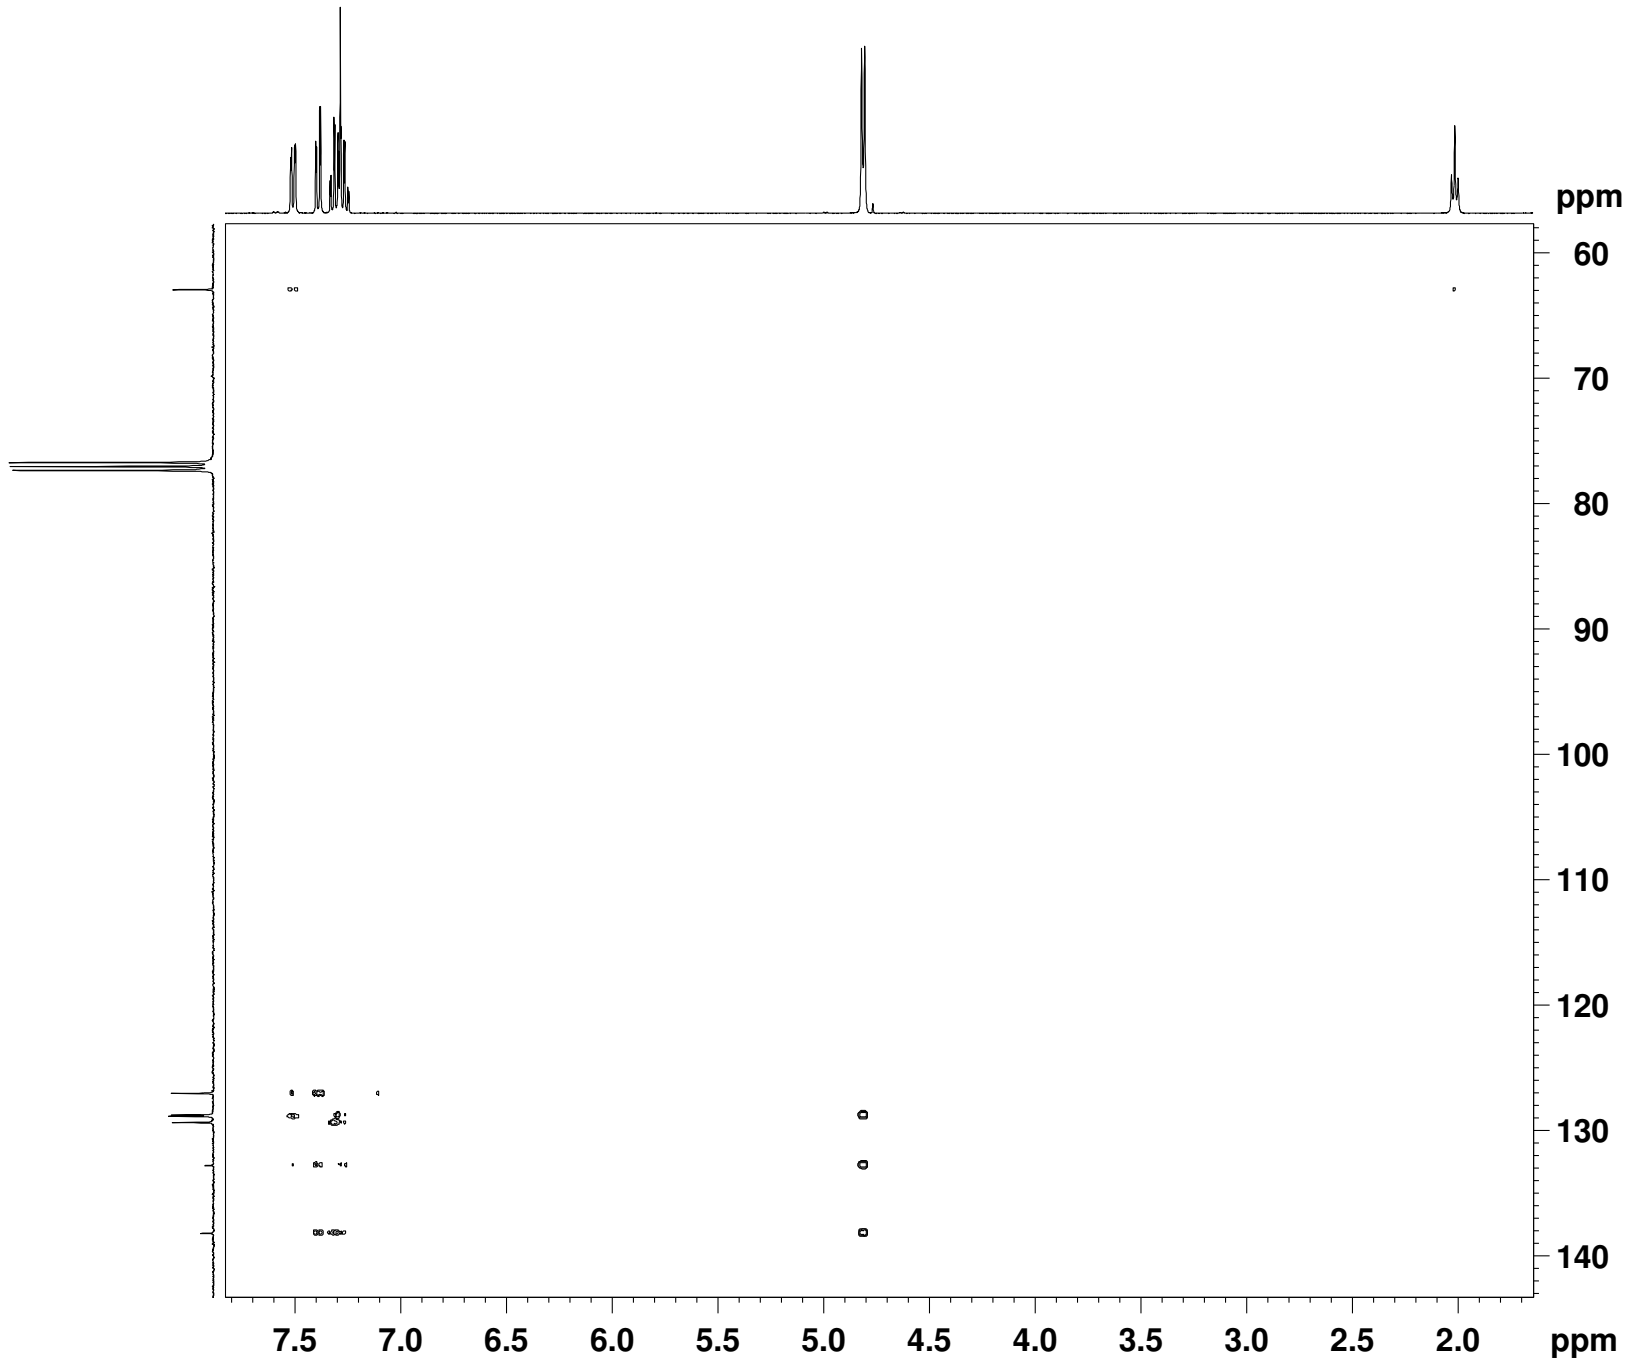


```
NAME              Un_45
EXPNO                 5
PROCNO                1
Date_          20120222
Time               9.41
INSTRUM        robinson
PROBHD   5 mm PABBO BB-
PULPROG    hmbcetgpl3nd
TD                 4096
SOLVENT           CDCl3
NS                    8
DS                   16
SWH            3591.954 Hz
FIDRES         0.876942 Hz
AQ            0.5702132 sec
RG                16384
DW              139.200 usec
DE                 6.50 usec
TE                298.2 K
CNST6       145.0000000
CNST7       165.0000000
CNST13        6.0000000
CNST30        0.5981152
D0           0.00000300 sec
D1           2.00000000 sec
D6           0.08333334 sec
D16          0.00020000 sec
IN0          0.00004970 sec

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H
P1                10.90 usec
P2                21.80 usec
PL1                0.00 dB
SFO1        400.1418006 MHz

======== CHANNEL f2 ========
NUC2                13C
P3                 8.05 usec
P24             2000.00 usec
PL2               -2.00 dB
SFO2        100.6253445 MHz
SP7               12.00 dB
SPNAM7      Crp60comp.4
SPOAL7            0.500
SPOFFS7            0.00 Hz

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1          SINE.100
GPNAM3          SINE.100
GPNAM4          SINE.100
GPNAM5          SINE.100
GPNAM6          SINE.100
GPZ1              80.00 %
GPZ3              14.00 %
GPZ4              -8.00 %
GPZ5              -4.00 %
GPZ6              -2.00 %
P16             1000.00 usec
ND0                   2
TD                  256
SFO1           100.6253 MHz
FIDRES        39.306774 Hz
SW              100.000 ppm
FnMODE    Echo-Antiecho
SI                 4096
SF          400.1400000 MHz
WDW               QSINE
SSB                   2
LB                 0.00 Hz
GB                    0
PC                 1.40
SI                 1024
MC2       echo-antiecho
SF         100.6152830 MHz
WDW               QSINE
SSB                   2
LB                 0.00 Hz
GB                    0
```